



200

Silikonerede lancetter
Silikonbelagte lancetter
Silikonoverdragna lancetter
silikonipäällysteistä lansettia

TRÆK NED FOR AT ÅBNE. • TREKK NED FOR Å ÅPNE.
• DRA NED FÖR ATT ÖPPNA. • AVAA VETÄMÄLLÄ ALASPAIN.



- MA** Används sammen med fingerprickere i Microlet®-familien.
- MD** Brukes med stikkene i Microlet®-familien.
- SV** Använd med blodprovstagare i Microlet®-familien.
- FI** Käytettäväksi Microlet®-pistolaiteiden tuoteperheen kanssa.

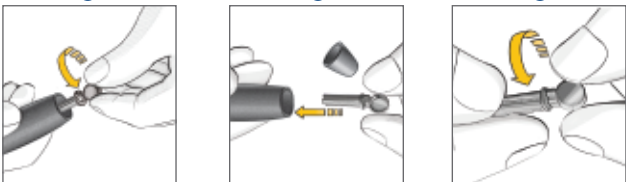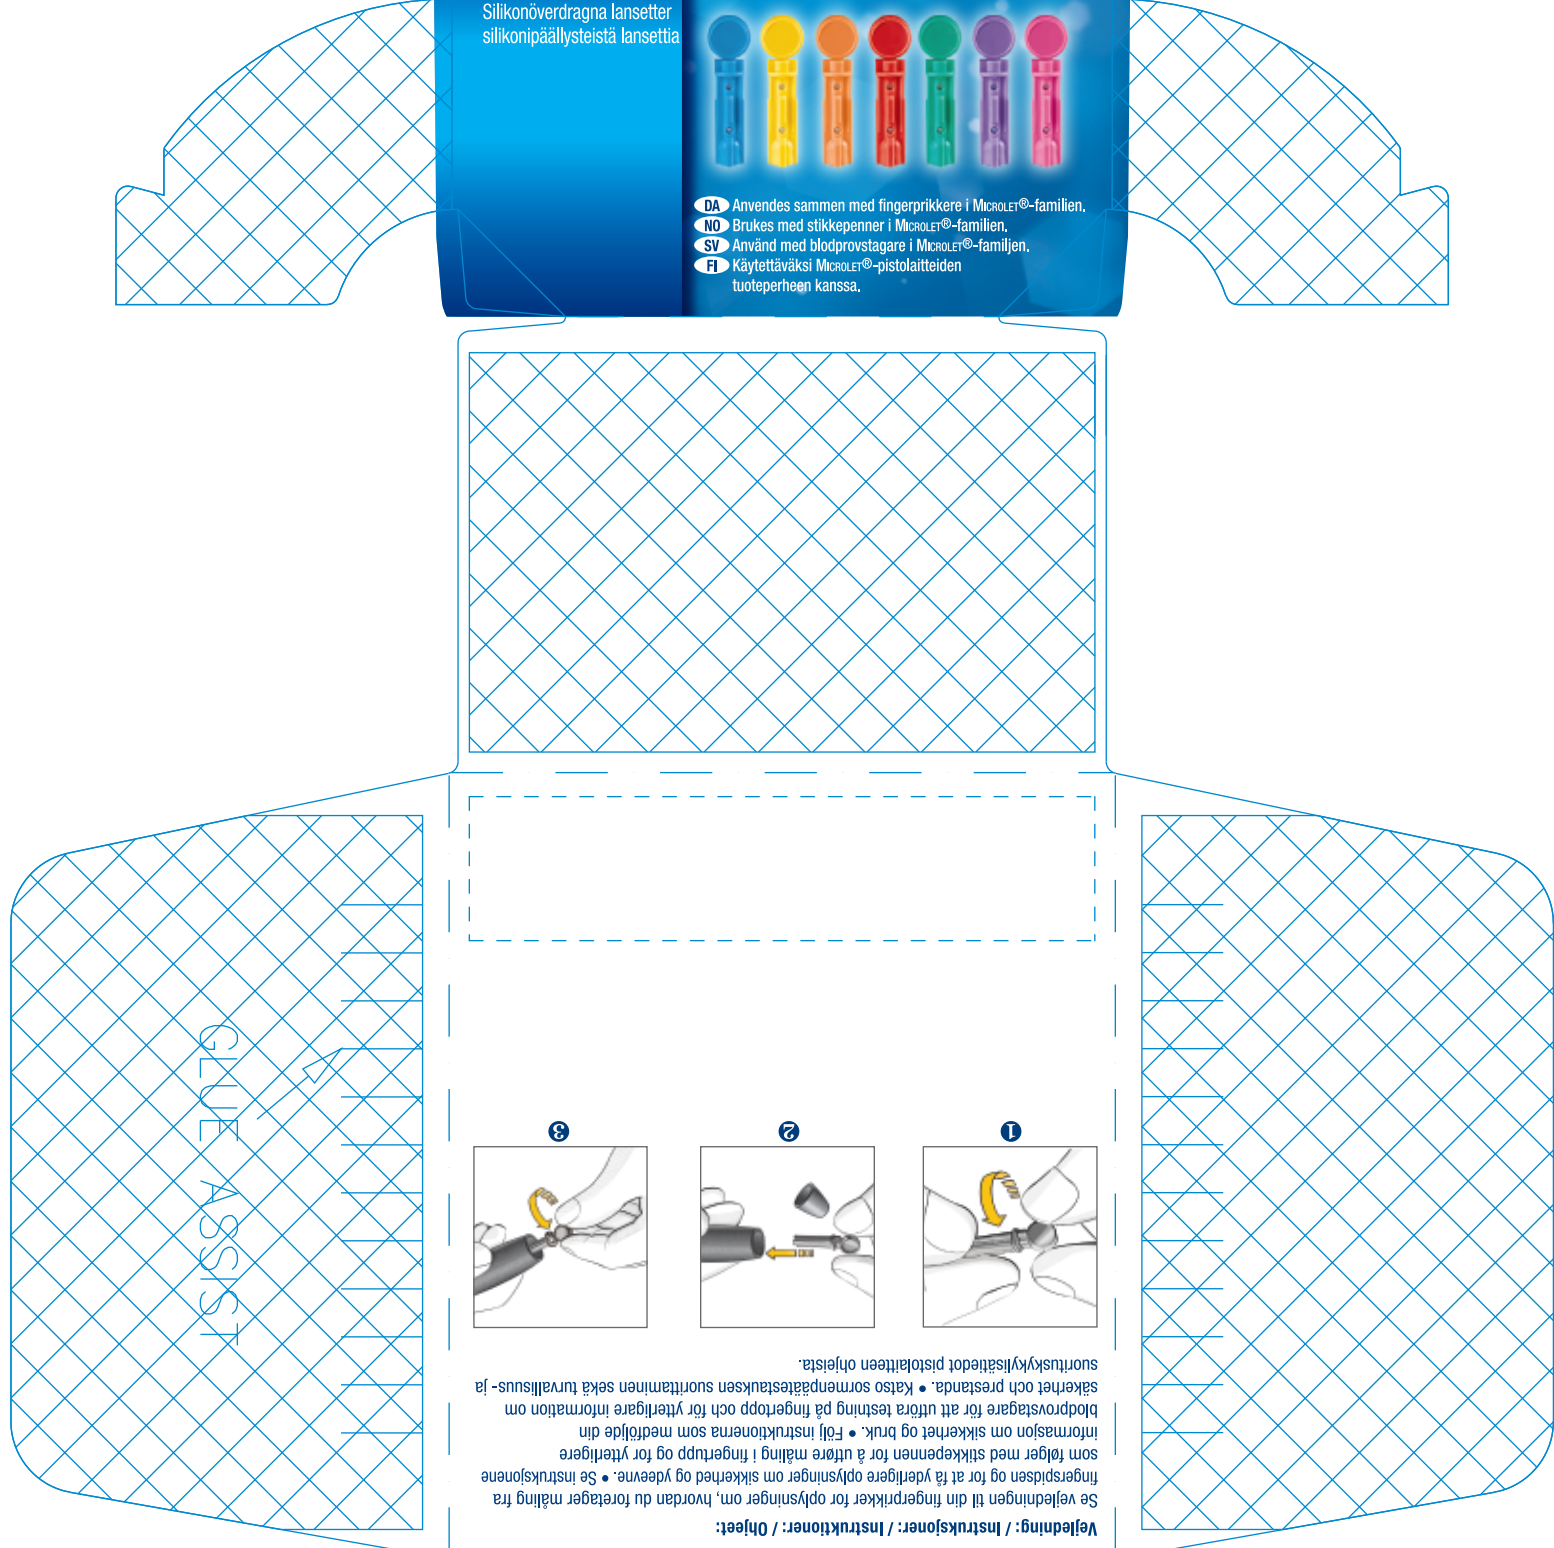

Vejledning / Instruksjoner / Instruktioner / Ohjeet:
Se vejledningen til din fingerpricker for oplysninger om sikkerhed og ydeevne. • Se instruksionsene fingerprisen og for at få yderligere oplysninger om sikkerhed og ydeevne. • Se instruksionserne som følger med sikkerheden for a udføre måling i fingertryk og for yderligere information om sikkerhed og brug. • Følg instruktionerne som medfølger din blodprovstager for at udføre besting på fingertryk og for yderligere information om sikkerhed og brug. • Hvis du har spørgsmål om sikkerhed eller brug, kontakt venligst din sundhedsmyndighed eller producenten.

Tilsløst brug: Microlet®-lancetten er en steril enhed til engangsbrug, der er beregnet til kapillærbloodprøvetagning fra en voksen eller et barn til måling af blodsukker. Lancetten er ikke beregnet til neonatal brug. • **Tiltenkt brug:** Microlet®-lancetten er en steril engangs enhed beregnet for at få en kapillærbloodprøve fra en voksen eller et barn for måling af blodsukker. Lancetten skal ikke bruges på nyfødte. • **Avsedd användning:** Lancetten Microlet® är ett sterilt instrument för engångsbruk, avsett för att ta ett kapillärt blodprov från en vuxen eller ett barn för glukosövervakning. Lancetten är inte avsedd för neonatal användning. • **Käyttökäyttö:** Microlet®-lansetti on kertakäyttöinen, steriili laite, joka on tarkoitettu kapillaarverenäytteen ottamiseen aikuiselta tai lapselta glukosin seurantaan varten. Lansettia ei ole tarkoitettu käyttöön vastasyntyneille.
ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn. Denne pakning indeholder små dele, der kan udgøre en kvalningsfare, hvis de sluges ved et uheld. • **ADVARSEL:** Opbevares utilgængelig for barn. Denne pakningen inneholder små deler som kan forårsake kvælning hvis de svelges. • **VARNING:** Förvaras utom räckhåll för barn. Detta paket innehåller små delar som kan leda till kvävning om de sväljs oavsiktligt. • **VAROITUS:** Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tämä pakkaus sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen vahingossa nieltynä.

Importeres og distribueres af:
Ascensia Diabetes Care Denmark ApS
Amager Strandvej 390, 1. sal
DK-2770 Kastrup
Kundeservice: +45 42 82 80 00
diabetesdk@ascensia.com

Importert og distribueret av:
Ascensia Diabetes Care Norway AS
Strandveien 50
1366 Lysaker
Norge
Kundeservice: +47 67 12 28 00
Fax: +47 67 12 28 01
diabetes.t@ascensia.com

Importerad och distribuerad av:
Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Gustav III:s Boulevard 34, plan 4
169 73 Solna
Sverige
Kundsupport: 020 - 83 00 84
diabetes@ascensia.com

Maahantuja ja jakelija:
Ascensia Diabetes Care Finland Oy
Hiilikatu 3
00180 Helsinki
Suomi
Asiakaspalvelu: 0800 172 227
Tilaukset: 09 7479 0393
Fax: 09 8565 7310
diabetes.2@ascensia.com

www.diabetes.ascensia.com

Fremstillet i Polen. • Laget i Polen. • Tillverkad i Polen.
• Valmistettu Puolassa.

Microlet

Farvede lancetter • Färgade lansetter • Färgade lancetter
• Värilliset lansetti

Enkel og skånsom testning
Enkel, problemfri måling
Enkel, smidig testning
Hjelpo, lähes kivuton
näyttööntto

Microlet

Farvede lancetter • Färgade lansetter • Färgade lancetter
• Värilliset lansetti

REF 00937483
STERILE R

Lancetten er steril, indtil beskyttelsehatten tages af. Må ikke bruges, hvis lancetten er beskadiget eller beskyttelsehatten er fjernet. Skal altid bortskaffes som medicinsk affald.
Lansettien är steril tills skyddshattens tas bort. Använd inte om den är skadad eller öppnas oavsiktligt. Kassera alltid som medicinsk avfall.
Lansetti on steril, kunnes suojus on irrotettu. Älä käytä, jos se on vaurioitunut tai avattu tahattomasti. Hävitä se aina lääkejätteenä.
Hvis der er sket en uheldig handling under brug af denne enhed eller som følge af dens brug, bedes du informere producenten og/eller forhandleren samt det relevante BSEY i dit land.
Hvis det har opstået en alvorlig hændelse under brugen af denne enhed eller som følge af dens brug, skal dette rapporteres til producenten og/eller dens autoriserede repræsentant og til nasjonale myndigheter.
Om en alvorlig incident har inträffat under eller till följd av användningen av detta instrument måste du rapportera detta till tillverkaren och/eller dess auktoriserade representant och till din nationella myndighet.
Jos tämän laitteen käyttöön aikana tai sen käytön seurauksena on ilmennyt vakava onnettomuus, ilmoita siitä valmistajalle ja/tai sen valtuutetulle edustajalle ja kansalliselle viranomaiselle.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merz-Strasse 10
4052 Basel, Switzerland

EC MD I U
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 102
20156 Milano, Italy

ASCENSIA
Diabetes Care

0°C 40°C
2797

90011258 5970R Rev. 03/23
© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheder forbeholdes. • Alle rettigheter forbeholdt.
• Med ensamrätt. • Kaikki oikeudet pidätetään.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logoet og Microlet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, Ascensia Diabetes Care-Logoet og Microlet er varemærker og/eller registrerte varemærker for Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care och Microlet är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, Ascensia Diabetes Care-Logo ja Microlet ovat Ascensia Diabetes Care Holdings AG -yhtiön tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

